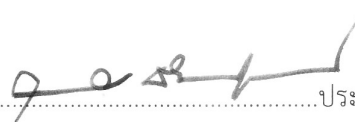




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดย่อยตัวอย่างกรดอะมิโน


1. เป็นเตาให้ความร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิสามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณหภูมิห้องถึงไม่น้อยกว่า 200 °C โดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ± 0.2 °C ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์หรือระบบดิจิทัล
2. ตัวให้ความร้อน (Heater) มีขนาดไม่น้อยกว่า 390 วัตต์
3. สามารถตั้งเวลาในการทำงานของเครื่องได้
4. มีระบบป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินปกติ
5. ขนาดของตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
6. มีคู่มือเนียบบล็อก สามารถใส่พอดีเต็มพื้นที่ให้ความร้อนของเครื่อง และสามารถใส่หลอดทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 mm ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หลอด
7. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
8. รับประกันคุณภาพ 2 ปี
9. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1 ชุด
10. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
11. ส่งมอบ และทดลองใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอกาส)



.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคูลี)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางเจลา พิทักษ์สินสุข)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรอาวุธ ชูกระชั้น)

ชุดย่อยตัวอย่างกรดอะมิโน
