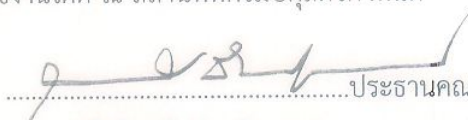


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องฟอกอากาศสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ชนิดเคลื่อนย้ายได้

1. เป็นเครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ที่สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา, กลิ่นสารเคมี และสิ่งเจือปนในอากาศอื่นๆ ได้
2. สามารถใช้งานกับห้องที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบฟอกอากาศ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
 - 3.1 กรณี ระบบฟอกอากาศใช้ Filter ให้มีรายละเอียด ดังนี้
 - 3.1.1 มีแผ่นกรองหยาบ (Pre-filter) ซึ่งสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้
 - 3.1.2 มีแผ่นกรองละเอียดชนิด HEPA หรือ Electronic air filter ที่มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศที่มีอนุภาคฝุ่นละอองขนาด 0.008 ไมครอน ได้
 - 3.2 กรณี ระบบฟอกอากาศไม่ใช้ Filter ให้มีรายละเอียด ดังนี้
 - 3.2.1 มีระบบฆ่าเชื้อโรคเป็นระบบ Photo Catalytic Oxidation
 - 3.2.2 มีหลอด UV จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลอด
 - 3.2.3 สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ไม่น้อยกว่า 98%
4. สามารถปรับระดับความแรงของพัดลมได้ ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
5. สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบ Manual และแบบ Remote ชนิดไร้สาย
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือผลิตตามมาตรฐาน CE
7. เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีส่วนประกอบทุกชนิดเป็นของแท้ตามมาตรฐานของเครื่องฟอกอากาศที่จำหน่ายในท้องตลาด
8. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือฉบับภาษาไทยและอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
10. รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมตรวจสอบสภาพเครื่องและทำความสะอาดภายในตัวเครื่องทุก 4 เดือน ภายในระยะเวลาประกัน
11. ติดตั้ง ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.62





.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารงโสภาส)



.....กรรมการ
(นางสาวภัทริณ โอภาสชัยทัตต์)


.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางจริยา บุญจรัสชชะ)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

