



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะ


1. เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะ มีหน้าจอแบบ LCD หรือ LED แสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10 องศาเซลเซียส ถึงไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
3. สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 2 %RH ถึงไม่น้อยกว่า 98 %RH โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 %RH
4. มีค่าความแม่นยำ (Accuracy) ของอุณหภูมิผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และมีค่าความแม่นยำ (Accuracy) ของความชื้นสัมพัทธ์ผิดพลาดไม่เกิน ± 2 %RH ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 40-80 %RH
5. สามารถแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดและต่ำสุดได้
6. สามารถกด Reset ค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้
7. ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ ขนาด 9 โวลท์
8. เครื่องมือต้องได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่อุณหภูมิ 20, 25 และ 30 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 40, 50, 60 และ 80 %RH พร้อมส่งใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในวันที่ส่งมอบ
9. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
13. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

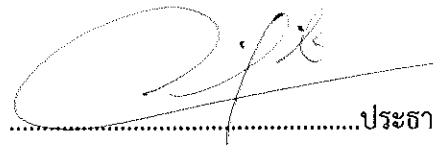



.....ประธานคณะกรรมการ


(นายวรวิชัย วรอำศวปติ)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางสาวภัทริน โอกาสชัยทัตต์)



.....กรรมการ
(นางสาวฐิติกานต์ จีรกิตติสุนทร)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตน์ธัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายอุทร ศรีแสง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสิริมภรณ์ เกื้อนถ้ำแก้ว)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)