

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร

1. มีลักษณะเป็นตู้นอน สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ขนาดความจุภายในตู้ไม่น้อยกว่า 160 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. ภายนอกมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 70x120x100 เซนติเมตร
3. ภายในมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxลึก) 55x105x28 เซนติเมตร
4. ตัวตู้ภายในและภายนอกทำด้วยโลหะสเตนเลส เกรด 304
5. ฉนวนเก็บความเย็นทำจากโพลียูรีเทนโฟมชนิด CFC-Free
6. คอมเพรสเซอร์เป็นชนิด Hermetic กำลังขนาดไม่น้อยกว่า 330 วัตต์ ใช้สารทำความเย็นชนิด R134a
7. มีประตูอยู่ด้านบนตู้และมีลักษณะตรงกลางเป็นช่องกระจก 2 บาน สามารถเลื่อนเปิด-ปิด ได้
8. มีตัวตรวจวัดอุณหภูมิ ชนิด PT100 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด **ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.65**
9. ระบบหมุนเวียนอากาศเป็นแบบ Air force circulation
10. มีล้อเลื่อน และสามารถล็อกล้อได้ จำนวน 4 ล้อ
11. ใช้ไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
12. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี และบริการตรวจสอบสภาพทุก 6 เดือน ในระหว่างการรับประกัน
13. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
17. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

พรศักดิ์ ทอดทูล

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1-21-5

ประธานอนุกรรมการ

(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)

รองประธานอนุกรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)

อนุกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เปรมปรีดี)

อนุกรรมการ

(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)


อนุกรรมการ

(นางสาวนันท์มนัส สีคง)

อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)

ภาพประกอบ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร

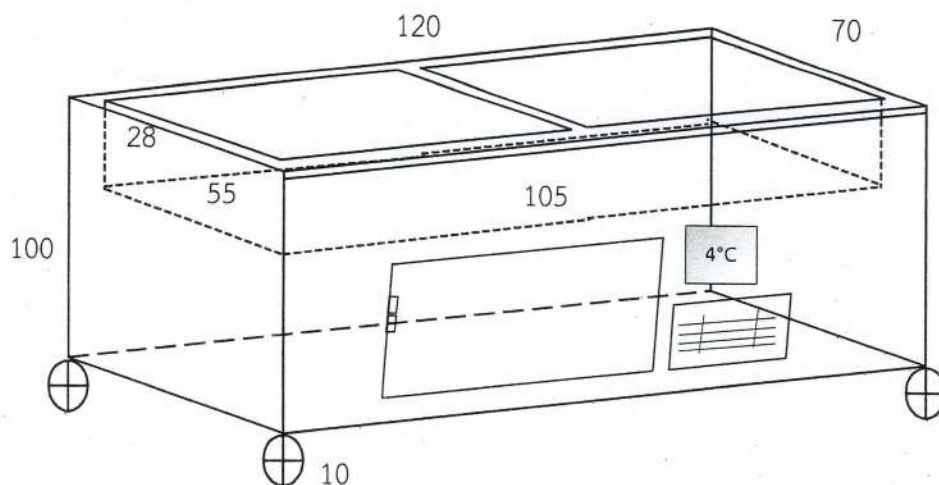

หน่วย : เซนติเมตร

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๖๕

[Signature]

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

[Signature]

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร

[Signature]