


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เก็บเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ และสารเคมี

1. โครงสร้าง ผนังตู้ และชั้นวางทำจากโลหะสแตนเลส เกรด 304
2. ขนาดตู้มีความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 40 x 75 x 160 เซนติเมตร
(มีลักษณะตามรูป)
3. ภายในตู้มีชั้นวางอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั้น
4. ประตูตู้มี 2 บาน เป็นประตูกระจกใสบานพับและมีกุญแจล็อก
5. มีล้อ 4 ล้อทำจากไนลอนหรือยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร
สามารถล็อกล้อได้อย่างน้อย 2 ล้อ
6. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
7. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
8. ส่งมอบ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

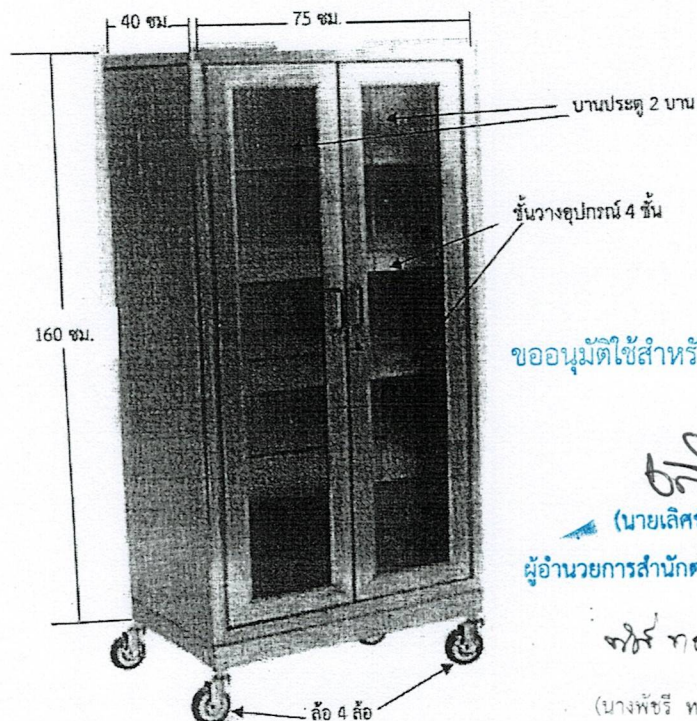

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2565

[Signature]

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

[Signature]

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

อนุกรรมการ

(นางสาวสินีพรรณ ภูวนันท์)

อนุกรรมการ

(นายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม)

อนุกรรมการ

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

อนุกรรมการ

(นางสาวชญญกรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)

อนุกรรมการ

(นางสาวศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส)

อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)