

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


ถังออกซิเจนขนาด 2 คิว พร้อมรถเข็นและอุปกรณ์ครบชุด

1. เป็นถังเหล็กไร้รอยต่อสี่เหลี่ยมสำหรับงานทางการแพทย์
2. ขนาดถังออกซิเจนบรรจุไม่น้อยกว่า 2 คิว พร้อมก๊าซออกซิเจนเต็มถัง
3. ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
 - 3.1 ชุดปรับแรงดันออกซิเจน โดยที่ข้อต่อออกซิเจน มี filter ที่ปลายข้อต่อเพื่อกรองฝุ่นออกจากถัง มีมาตรวัดออกซิเจนแสดงแรงดันภายในถัง
 - 3.2 ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน
 - 3.3 ขวดน้ำให้ความชื้นทำด้วยพลาสติกใส มีขีดบอกระดับน้ำ
 - 3.4 รถเข็นถังออกซิเจนมีขนาดที่สามารถบรรจุถังออกซิเจนขนาดบรรจุ 2 คิวได้ โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกลม มีที่รัดถังออกซิเจนทำด้วยเหล็กแบน และมีล้อสำหรับเข็นเคลื่อนที่ได้
 - 3.5 มีประแจปากตาย สำหรับถอดและใส่ชุดปรับแรงดันออกซิเจนกับถังออกซิเจน
4. ได้รับรองมาตรฐาน มอก.540-2555
5. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
6. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของอุปกรณ์
7. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
8. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
9. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ ที่กรมปศุสัตว์กำหนด





ประธานอนุกรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


 อนุกรรมการ
(นางสาวสินีพรณ์ ภูวนันท์)


 อนุกรรมการ
(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

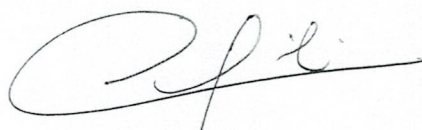

 อนุกรรมการ
(นางสาวศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส)


 อนุกรรมการ
(นายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม)


 อนุกรรมการ
(นางสาวชญญภรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)


 อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2565


 นายวรวิทย์ วรวิทย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


 (นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์