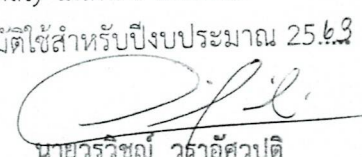


รายละเอียดคุณลักษณะ
เครื่องวิเคราะห์ความชื้น (Moisture analyzer)

1. เป็นเครื่องหาความชื้นของสารโดยใช้หลอดฮาโลเจน
2. หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ backlit สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีกราฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
3. สามารถรายงานผลในการวิเคราะห์ความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 2 แบบ คือ %ความชื้น และ %น้ำหนักแห้ง
4. สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50 ถึงไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส และสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้ครั้งละไม่เกิน 1 องศาเซลเซียส
5. สามารถรองรับน้ำหนักตัวอย่างได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 70 กรัม และมีค่า Readability ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม
6. มีโปรแกรมทำความร้อนไม่น้อยกว่า 2 โปรแกรม ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕.3
7. สามารถสร้างและบันทึกโปรแกรมวิธีการวิเคราะห์ได้
8. มีลูกน้ำแสดงอยู่ด้านหน้าเครื่อง 
นายรณรัชฎ์ วรวัชรสมบัติ
9. มีจานวางตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
10. มีถาดสำหรับใส่ตัวอย่างทำจากอลูมิเนียมขนาดพอดีกับจานวางตัวอย่างจำนวนไม่น้อยกว่า 80 ชิ้น
11. มีชุดพิมพ์ผลสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องวิเคราะห์ความชื้นได้ จำนวน 1 ชุด พร้อมกระดาษพิมพ์จำนวน 10 ม้วน
12. เฉพาะส่วนวิเคราะห์ความชื้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001
13. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
14. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้ ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.5
15. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
16. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
17. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง 
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
18. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)



กรรมการ
(นายวรา วรงค์)


กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร์)



กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)


กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)


กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


กรรมการ
(นายณนุเบศ เนินทอง)


กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธนันท์)


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรawat ชูกระชั้น)