

คว.113/64

คว.84/65

คว. 3 / 66

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตีบดสมตัวอย่าง (Stomacher) ขนาด 3,500 มิลลิลิตร

1. เป็นเครื่องที่ใช้ตีบดสมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา
2. สามารถตั้งค่าความเร็วรอบและเวลาได้ มีหน้าจอแสดงผล
3. สามารถปรับตั้งค่าอัตราการตีบดได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
4. สามารถใส่ตัวอย่างปริมาตรสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,500 มิลลิลิตร
5. สามารถใช้งานร่วมกับถุงพลาสติกอย่างหนาที่ใช้บรรจุตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 380 x 510 มิลลิเมตร
6. มีถุงพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 380 x 510 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชิ้น
7. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
8. มีคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี พร้อมตรวจสอบสภาพเครื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เวลาประกัน
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้กับผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
14. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..65



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..66




(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....อนุกรรมการ

(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

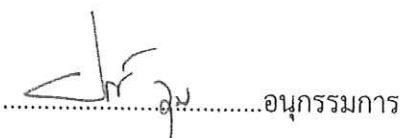

(นางสาวปาริชาต ชุนพรม)



(นายพงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์)

.....ประธานอนุกรรมการ


(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวพิชญา ไผทสิทธิ์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายณฤเบศ เนินทอง)