

ทว. ๑๕๓/๖๓

ทว. ๑๙๓/๖๔

ทว. ๑๗๘/๖๖

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่

1. เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) แบบเคลื่อนที่ พร้อมกระเป๋าเก็บเครื่อง
2. สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงปริมาณ โดยรายงานผลในรูปแบบกราฟและหาค่า Melting Curve analysis ได้
3. สามารถวิเคราะห์หลอดตัวอย่าง PCR ขนาด 0.1 หรือ 0.2 มิลลิลิตร ได้จำนวนสูงสุดครั้งละไม่น้อยกว่า 16 หลอด

4. ระบบทำอุณหภูมิแบบ Peltier ที่สามารถทำอุณหภูมิ 40 ถึงไม่น้อยกว่า 99 องศาเซลเซียสได้ โดยมีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 3 องศาเซลเซียสต่อวินาที โดยมีค่า accuracy ผิดพลาดได้ตั้งแต่ ± 0.2 ถึงไม่เกิน ± 0.25 องศาเซลเซียส ที่ 65 องศาเซลเซียส หรือตลอดช่วงที่เครื่องทำอุณหภูมิได้ (total basic control : tbc) และมีค่า Uniformity ผิดพลาดได้ตั้งแต่ ± 0.05 ถึงไม่เกิน ± 0.4 องศาเซลเซียส

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖

5. มีแหล่งกำเนิดแสงแบบ Solid-state LEDs หรือ Blue LED หรือ LED excitation
6. มีระบบตรวจวัดชนิด Photodiode หรือ CMOS
7. สามารถตรวจวัดสัญญาณการเพิ่มปริมาณของสารพันธุกรรมได้ไม่น้อยกว่า 2 สี คือ FAM และ HEX หรือ VIC

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

8. สามารถสั่งงานในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือที่หน้าจอของตัวเครื่อง หรือสั่งงานผ่านโปรแกรมในแฟลชไดรฟ์ และสามารถนำข้อมูลออก (Export) ได้ในรูปแบบ JPEG หรือ PDF หรือ CSV
9. มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และโปรแกรมวิเคราะห์ ประมวลผลและรายงานผล มีลักษณะดังนี้

9.1 ระบบปฏิบัติการ windows 10 หรือดีกว่าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และรายงานผลได้

9.2 หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๕

9.3 ระบบประมวลผล (CPU) รุ่นไม่น้อยกว่า core i3 2.2 GHz หรือดีกว่า

9.4 หน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

9.5 หน่วยจัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 500 GB

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

10. เครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 4 กิโลกรัม

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

11. ใช้กับไฟฟ้า 220 volts 50 hertz ได้ หรือมี AC adapter เพื่อใช้งานกับเครื่องมาด้วย

12. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้

12.1 ชุดสำรองไฟแบบเคลื่อนที่ที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่และสามารถจ่ายไฟได้ทั้งกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC) โดยสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 120,000 mAh จำนวน 1 ชุด

12.2 อุปกรณ์ชุดจ่ายสารละลายแบบปรับปริมาตรได้ ขนาด 0.5-10 ไมโครลิตร 10 -100 ไมโครลิตร และ 100-1,000 ไมโครลิตร จำนวนอย่างละ 1 อัน

13. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 เล่ม

นางพัชรี ทองคำคุณ
(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


14. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเครื่องมืออย่างน้อย 1 ปี และมีบริการสอบเทียบเครื่องมืออย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างรับประกัน
15. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบของตามที่เสนอราคาไว้ในข้อ 9 ผู้ขายจะต้องจัดหาของที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่ามาส่งมอบแทน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการตรวจรับจะพิจารณา
18. ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
19. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
20. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.65



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

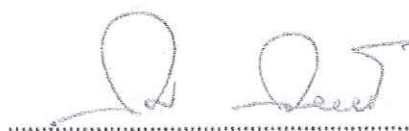

ประธานอนุกรรมการ

(นายสุชุม สนิธิพันธ์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.66




(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 อนุกรรมการ

(นายกิตติภักดิ์ สุจิต)

 อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐวุฒิ จิระ)



(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์