

คว.109/62

คว.4/63


คว.88/65

คว.71/66

รายละเอียดคุณลักษณะ  
เครื่องวิเคราะห์ความชื้น (Moisture analyzer)

1. เป็นเครื่องหาความชื้นของสารโดยใช้หลอดฮาโลเจน
2. หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ backlit สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีกราฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
3. สามารถรายงานผลในการวิเคราะห์ความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 2 แบบ คือ %ความชื้น และ %น้ำหนักแห้ง
4. สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50 ถึงไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส และสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้ครั้งละไม่เกิน 1 องศาเซลเซียส
5. สามารถรองรับน้ำหนักตัวอย่างได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 70 กรัม และมีค่า Readability ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม
6. มีโปรแกรมทำความร้อนไม่น้อยกว่า 2 โปรแกรม
7. สามารถสร้างและบันทึกโปรแกรมวิธีการวิเคราะห์ได้
8. มีลูกน้ำแสดงอยู่ด้านหน้าเครื่อง
9. มีจานวางตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
10. มีถาดสำหรับใส่ตัวอย่างทำจากอลูมิเนียมขนาดพอดีกับจานวางตัวอย่างจำนวนไม่น้อยกว่า 80 ชิ้น
11. มีชุดพิมพ์ผลสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องวิเคราะห์ความชื้นได้ จำนวน 1 ชุด พร้อมกระดาษพิมพ์จำนวน 10 ม้วน
12. เฉพาะส่วนวิเคราะห์ความชื้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001
13. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
14. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
15. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
16. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
17. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
18. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.63


  
นายวรวิทย์ วรวิชัย

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.65

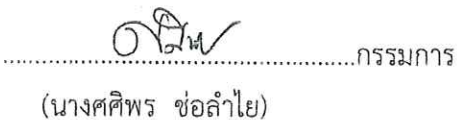
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

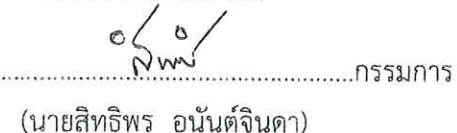
  
ประธานคณะกรรมการ  
(นายไพโรจน์ อารังโสภา)


  
กรรมการ  
(นายวรา วรงค์)

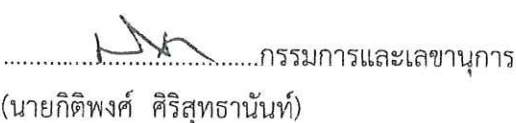
  
กรรมการ  
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

  
กรรมการ  
(นางศศิพร ช่อลำไย)

  
กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

  
กรรมการ  
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

  
กรรมการ  
(นายณฤเบศ เนินทอง)

  
กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธนันท์)

  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น) ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.66

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น (Moisture analyzer)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์