

คจ. 79/๖4 (แก้ไข)

คจ. 38/65

คจ. 77/66

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร

1. มีลักษณะเป็นตู้นอน สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ขนาดความจุภายในตู้ไม่น้อยกว่า 160 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. ภายนอกมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 70x120x100 เซนติเมตร
3. ภายในมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxลึก) 55x105x28 เซนติเมตร
4. ตัวตู้ภายในและภายนอกทำด้วยโลหะสแตนเลส เกรด 304
5. ฉนวนเก็บความเย็นทำจากโพลียูรีเทนโฟมชนิด CFC-Free
6. คอมเพรสเซอร์เป็นชนิด Hermetic กำลังขนาดไม่น้อยกว่า 330 วัตต์ ใช้สารทำความเย็นชนิด R134a
7. มีประตูอยู่ด้านบนตู้และมีลักษณะตรงกลางเป็นช่องกระจก 2 บาน สามารถเลื่อนเปิด-ปิด ได้
8. มีตัวตรวจวัดอุณหภูมิ ชนิด PT100 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.65
9. ระบบหมุนเวียนอากาศเป็นแบบ Air force circulation
10. มีล้อเลื่อน และสามารถล็อกล้อได้ จำนวน 4 ล้อ
11. ใช้ไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
12. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี และบริการตรวจสอบสภาพทุก 6 เดือน ในระหว่างการรับประกัน
13. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
17. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.66

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)

ประธานอนุกรรมการ

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รองประธานอนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)


อนุกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เปรมปรีดี)

อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)

อนุกรรมการ
(นางสาวนันทมนัส สีคง)

อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)

ภาพประกอบ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร

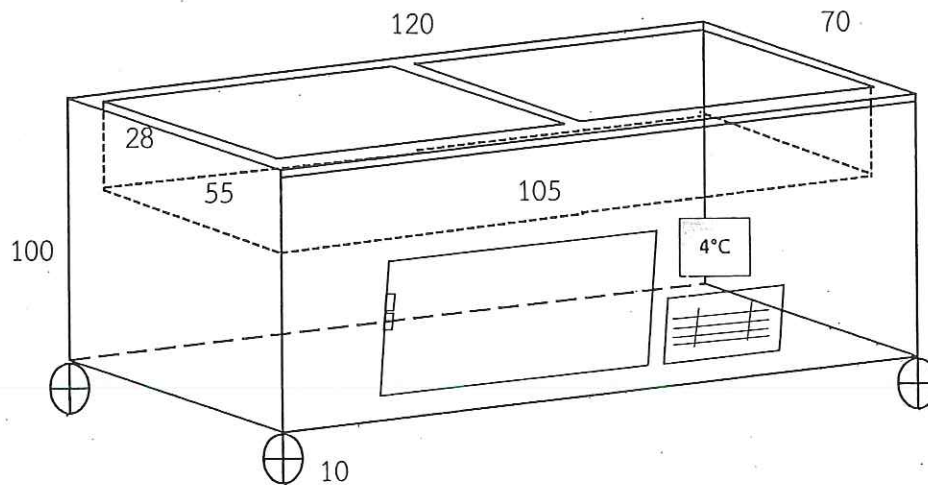

หน่วย : เซนติเมตร

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.66

[Signature]

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.65

[Signature]

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

[Signature]

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร

[Signature]