

คว.๑๑/๖๕

คว.๔๑/๖๖

คว.๗๐/๖๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้างเครื่องมือ ขนาดกว้าง 0.75 เมตร x ยาว 3.00 เมตร x สูง 0.80 เมตร

1. เป็นโต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้างเครื่องมือ ขนาดกว้าง 0.75 เมตร x ยาว 3.00 เมตร x สูง 0.80 เมตร (ตามรูป) ประกอบด้วย

- 1.1 พื้นโต๊ะปฏิบัติการทำจาก phenolic resin เคลือบผิวด้วย chemical resistant laminate ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด - ด่าง ตัวทำละลายและสารเคมีทั่วไป มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร

- 1.2 ตู้สำหรับเก็บของ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ตู้ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ทำด้วย particle board เกรด E1 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้งสองด้าน และปิดขอบด้วย PVC

- 1.2.1 มีบานประตูและลิ้นชัก ทำจากไม้ particle board เกรด E1 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ปิดพื้นผิวด้วยแผ่นลามิเนตทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วยวัสดุชนิด PVC

- 1.2.2 ขาตู้ ทำจากพลาสติก ABS ความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำ ได้ และมีแผ่นลามิเนตปิดบังขาตู้

- 1.2.3 มีลิ้นชักอยู่ด้านบนของตู้ สามารถเปิดปิดได้ง่าย

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖

- 1.3 อ่างล้างเครื่องมือ (unit sink) ประกอบด้วย

- 1.3.1 ตัวตู้ ทำด้วยไม้อัด หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตทั้ง 2 ด้าน

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ปิดขอบด้วย PVC หน้าบานประตูตู้เจาะช่องระบายอากาศ เพื่อป้องกันความชื้นพร้อม

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ติดตั้งตะแกรงพลาสติก

- 1.3.2 อ่างน้ำทำจากวัสดุ polypropylene จากการขึ้นรูปเป็ดโมลด์เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 420 x 840 x 300 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x ลึก) มีความหนา ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี พร้อมสะดืออ่างในตัว และระบบป้องกันน้ำล้น (over flow)

- 1.3.3 มี bottle trap ทำด้วยวัสดุ polypropylene ส่วนล่างเป็นสีขาวย่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนได้

- 1.3.4 มีก๊อกน้ำ 1 ทางตั้งพื้นทำด้วยทองเหลือง

- 1.3.5 มีฉากกั้นน้ำกระเด็นบนพื้นโต๊ะทำด้วยแผ่นอะคริลิกใส

2. มีปลั๊กไฟฟ้า 3 ขา 2 เต้ารับ ติดตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด


3. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

4. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

จก

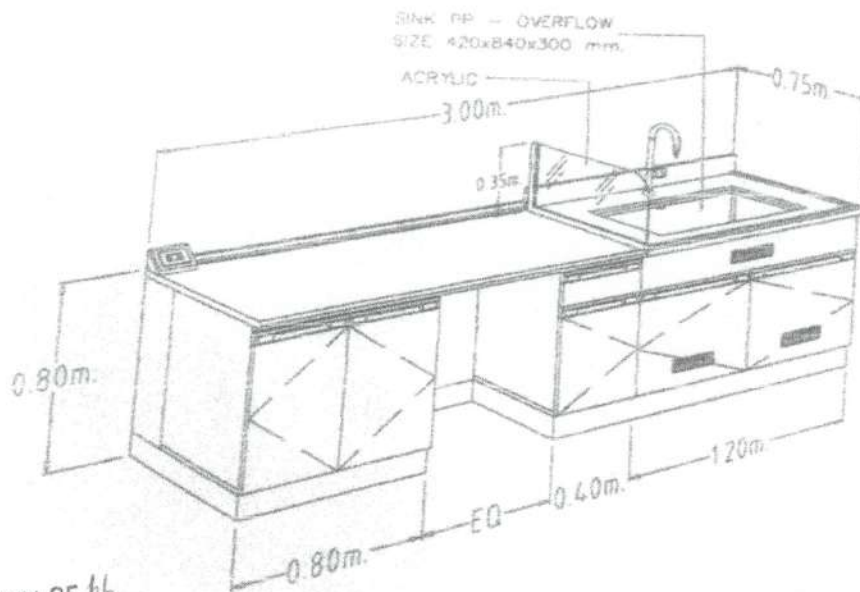

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖

[Signature]
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

[Signature] ประธานอนุกรรมการ

(นายกิตติชัย อุ้นจิต)

[Signature] อนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

[Signature] อนุกรรมการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงษ์)

[Signature] อนุกรรมการ

(นางสาวนิตยา จันทร์เสถียร)

[Signature] อนุกรรมการ

(นางสาวฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร)

[Signature] อนุกรรมการ

(นางธรรมรัฐ สุจิต)

[Signature] อนุกรรมการ

(นายกรัสนัย พรหมทองสุข)

[Signature] อนุกรรมการ

(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

[Signature] อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐกร ราชบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๗

[Signature]
(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมอ่างล้างเครื่องมือ ขนาดกว้าง ๐.๗๕ เมตร x ยาว ๓.๐๐ เมตร x สูง ๐.๘๐ เมตร