

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โต๊ะปฏิบัติการกลางขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร x 3.0 เมตร x 0.9 เมตร (กxยxส)

1. เป็นโต๊ะปฏิบัติการกลางขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร x 3.0 เมตร x 0.9 เมตร (กxยxส) ลักษณะตามรูป ประกอบด้วยส่วนประกอบ ดังนี้
 - 1.1 พื้นโต๊ะปฏิบัติการ ทำจากแผ่น phenolic resin เคลือบผิวด้วย chemical resistant laminate มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร มีคุณสมบัติสามารถทนการขีดข่วนและแรงกระแทกได้ดี ทนทานต่อสารเคมี, กรด-ด่าง, ตัวทำละลาย และสามารถทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 150 องศาเซลเซียส ส่วนใต้ work top มี water drop EDGE system ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ำและสารเคมีเข้าสู่
 - 1.2 โครงสร้างตัวโต๊ะ ตู้สำหรับเก็บของ หน้าบานตู้ ชั้นภายในตู้ และลิ้นชัก ทำด้วยไม้อัด หรือ particle board เกรด E1 ปิดผิวด้วยลามิเนตพลาสติกชนิด HPL(High Pressure Laminate) มีความหนารวมไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ปิดขอบด้วยวัสดุชนิด PVC
 - 1.3 ตู้สำหรับเก็บของ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ตู้ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร มีลักษณะดังนี้
 - 1.3.1 มีชั้นภายในตู้ สามารถปรับระดับได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั้น
 - 1.3.2 บานพับถ้ายทำด้วยสแตนเลส เป็นระบบไฮดรอลิก หรือระบบ Soft close พร้อมอะไหล่สำรอง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น
 - 1.3.3 ขาตู้ปรับระดับ ทำจากพลาสติก ABS สามารถปรับระดับความสูง - ต่ำได้ ส่วนที่สัมผัสกับพื้น และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพื่อป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ำเข้าสู่ตู้
 - 1.3.4 การยึดต่อประกอบตัวตู้ สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย
 - 1.3.5 มีกุญแจล็อคตู้ ทำด้วยโลหะเคลือบนิกเกิล
 - 1.4 ลิ้นชัก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ลิ้นชัก มีลักษณะดังนี้
 - 1.4.1 อยู่ด้านบนของตู้ สามารถเปิดปิดได้ง่าย
 - 1.4.2 มีกุญแจล็อคลิ้นชัก ทำด้วยโลหะเคลือบนิกเกิล
 - 1.5 มือจับเปิด - ปิด ฝังอยู่หน้าลิ้นชักและหน้าบานตู้ เป็นแบบ grip section post form handle emulation system ทำจากวัสดุ PVC โดยมีช่องว่างใส่ป้ายชื่อ
 - 1.6 ระบบไฟฟ้า มีลักษณะดังนี้
 - 1.6.1 เตารับไฟฟ้า เป็นเตารับคู่ 3 สาย 16 แอมป์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เตารับ เสียบได้ทั้งแบบขาแบน และขากลมในตัวเดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.
 - 1.6.2 กล่องเตารับไฟฟ้า ทำด้วย Polypropylene (PP) ฉีดขึ้นรูปสามเหลี่ยม เป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี สามารถยึดติดกับพื้นโต๊ะปฏิบัติการได้ ตัวกล่องมีร่องใส่ซิลยางกันน้ำรอบช่องร้อยสายไฟฟ้าใต้กล่อง
 - 1.6.3 มีการติดตั้งสายดินในระบบไฟฟ้า และเดินท่อสายไฟฟ้าอย่างเป็นระเบียบ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...68

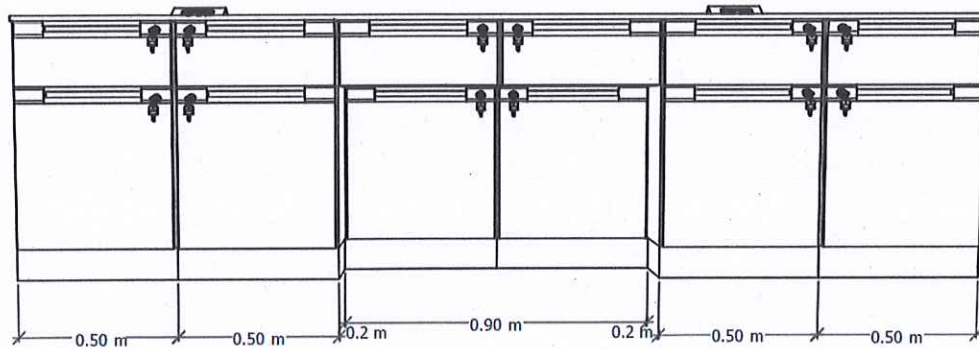

 (นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

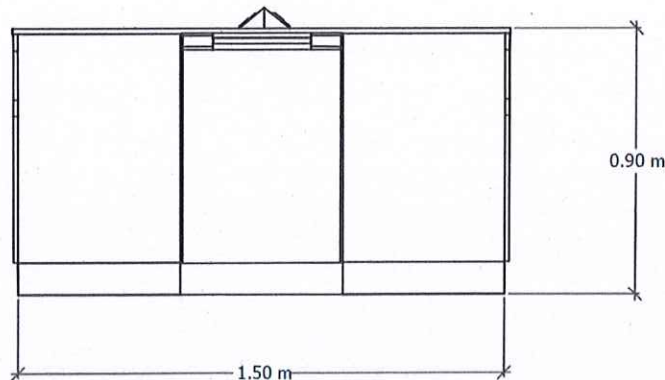
-
- Technical drawing of a rectangular table with the following dimensions and labels:
- Overall length: 3.00 m
 - Overall width: 1.50 m
 - Overall height: 0.90 m
 - Tabletop thickness: 0.20 m
 - Front panel height (left section): 0.50 m
 - Front panel height (right section): 0.45 m
 - Front panel height (bottom section): 0.20 m
 - Front panel width (left section): 0.50 m
 - Front panel width (right section): 1.00 m
 - Front panel width (bottom section): 0.20 m
 - Label: EQ
 - Label: ขอบหน้าต่างใช้สำหรับ (Window frame for use)
 - Label: (นายอุดม ใจ)
 - Label: ฝ่ายนายเวการสำนักตรวจสอบ (Department of the Inspector General)

(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



รูปด้านหน้า ทั้งสองฝั่ง



รูปด้านข้าง ทั้งสองฝั่ง

โต๊ะปฏิบัติการกลางขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร x 3.0 เมตร x 0.9 เมตร (กxยxส)

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาววิษุพันธ์ สิววรรณ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางปาริชาต พูนขวัญ)

.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพ็ชร)

.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรพ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์